



Publicado no D.O.C.  
Dia 25/09/22 Pág. 25..

**TERMO ADITIVO Nº 086/2022  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS**

**PROCESSO Nº:** 2014-0.337.134-9

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** FUNDAÇÃO DO ABC

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aquisição de Material Permanente - Contrapartida BID – UBS Parque São Rafael

**VALOR:** R\$ 138.882,00 (cento e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais)

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, respondendo pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF 57.571.275/0001-0, inscrita no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015– SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:



### CLÁUSULA PRIMEIRA

1. Fica estabelecido o valor de **R\$ 138.882,00 (cento e trinta e oito mil e oitocentos e oitenta e dois reais)**, para aquisição de material permanente para a UBS Parque São Rafael. O pagamento das despesas de investimento será realizado em uma única parcela.
2. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.11.10.301.3003.5.204.4.4.50.52.00 fonte 00.

### CLÁUSULA SEGUNDA

1. O recurso terá que ser utilizado em até 90 dias, sob pena de perda da utilização do mesmo, levando em conta que os processos de aquisições serão apresentados de forma individualizada por Unidade de Saúde.
2. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da aquisição dos equipamentos, para a respectiva prestação de contas e patrimonialização, que deverá conter obrigatoriamente a planilha descritiva de pesquisa de preço por item de despesa, além da documentação comprobatória da regularidade da aquisição e do recebimento;
3. A Prestação de Contas será feita em caráter especial, acompanhada das notas fiscais dos materiais comprados e recibos de pagamento, em conformidade com os manuais de prestação de contas vigentes, via webssas destinado a SMS/CPCS.
4. Caso haja saldo financeiro remanescente após a aquisição dos materiais permanentes constantes no Anexo I, o montante correspondente deverá ser devolvido aos cofres municipais imediatamente após a prestação de contas

### CLÁUSULA TERCEIRA


1. Os materiais permanentes adquiridos com base no presente Termo Aditivo deverão permanecer no mínimo 5 (cinco) anos afetados à unidade destinatária, por se tratarem de contrapartidas ao BID em razão do contrato de Empréstimo 4641/0C-BR
2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015–SMS/NTCSS



E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.


São Paulo, 31 de agosto de 2022.

  
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste  
\_\_\_\_\_  
**Nilza Maria Piassi Bertelli**  
Coordenadoria Regional de Saúde  
Leste

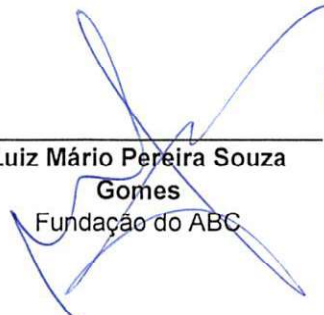  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Mário Pereira Souza  
Gomes**  
Fundação do ABC

  
\_\_\_\_\_  
**Hugo Macedo Junior**  
Fundação do ABC

Testemunhas:

  
Nome: DARLICE DA MOTA SOARES

RG: 

Nome: 

**Aline Correia de Araújo**  
RF: 729.908.1  
CRS-Leste / Assessoria Técnica




**ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO	
Contrato de Gestão R009/2014 – Rede Assistencial de saúde de São Mateus	
Unidade: UBS Parque São Rafael	
Tipo de Despesa	Valor
Investimento	R\$ 138.882,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 138.882,00</b>

**ANEXO II – RELAÇÃO DE BENS E DISTRIBUIÇÃO POR SALA**

UBS PQ. SÃO RAFAEL - DRA. ORA ROSEN

LOCAL	DESCRIÇÃO	DESCRIPTIVO DETALHADO	QUANT	VALOR UNIT ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
ESTERILIZAÇÃO	AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS 110V	<p>autoclave, tipo vertical, capacidade aproximada para 75 litros, esterilizador a vapor de água saturada com remoção de ar por alto vácuo e gerador de vapor incorporado ao equipamento para esterilização de material médico-hospitalar. revestimento externo construído em chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado. câmara interna com formato retangular, capacidade mínima de 75 litros e dimensões mínimas de 410 x 410 x 600mm (a x l x p), feita em chapa de aço inoxidável aisi 316l, ou superior, com espessura mínima de 4,7mm e acabamento polido sanitário. dimensões externas 150 x 830 x 990mm (a x l x p). a câmara deverá conter um único dreno de descarga localizado a não mais de 300mm da borda da porta do esterilizador e entrada para sensores de validação com diâmetro de 01 (uma) polegada e flange bsp. câmara externa em aço inoxidável aisi 304, ou superior, com espessura mínima de 4,7mm. isolamento térmico por manta mineral de lã de rocha revestida com chapa de alumínio para baixa dissipação de calor ao ambiente entre as câmaras. tubulações ou conexões sob o revestimento de isolamento térmico em aço inoxidável; base em aço carbono com tratamento anti-corrosivo/anti-oxidante, com pintura eletrolítica e pés reguláveis que permitam a inclinação e o nivelamento do equipamento; porta de abertura e fechamento por sistema de volante central termoisolante, que movimentem uniformemente os braços concêntricos em direção aos orifícios na flange; a porta e a câmara deverão ser vedadas por guarnição de silicone localizada na borda da câmara de esterilização, não necessitando ser pressurizada por vapor ou ar comprimido. construída em aço inoxidável, com acabamento polido sanitário. controlador lógico programável, microprocessado, com no mínimo treze ciclos pré-programados de fábrica; painel e comando da autoclave gerenciados com as seguintes características mínimas: (1) botão liga/desliga; (2) display alfanumérico com membrana protetora para visualização, retroiluminado, que indique as mensagens de fases, processo, erro e dos parâmetros do ciclo; (3) os ciclos mínimos pré-configurados deverão ser: (a) ciclo para esterilização de pacotes de tecidos; (b) ciclo para borrachas/silicones; (c) ciclo para luvas; (d) ciclo para vidrarias; (e) ciclo para instrumental embalado; (f) ciclo flash para instrumental desembalado; (g) ciclo para líquidos; (h) ciclo para termorresistentes; (i) ciclo para próns; (j) ciclo flash; (l) ciclo para testes de vácuo; (m) ciclo para teste bowie &amp; dick; (n) teste de estanqueidade (leak test); (o) mínimo de 03 (três) ciclos abertos para programação pelo usuário/operador; programações: (1) temperatura de esterilização na faixa de 100º a 134ºc; (2) tempo de esterilização de 00 a 99 minutos; (3) tempo de secagem de 00 a 99 minutos; (4) senha para programação de parâmetros; (5) impossibilidade de alteração dos parâmetros após o ciclo iniciado; (6) impossibilidade de início do ciclo caso as portas estejam abertas; (7) leitura digital da temperatura na câmara interna; (8) leitura digital da pressão das câmaras interna e externa; (9) leitura digital do tempo de esterilização; (10) leitura digital do tempo de secagem; (11) teclas para visualização de parâmetros e seleção de ciclo; (12) tecla para início de ciclo; (13) teclado alfa numérico para seleção e programação dos parâmetros dos ciclos; (14) controle das pressões das câmaras internas e externas através de transdutores de pressão com indicações dos valores no display; (15) controle da temperatura da câmara interna através de sensor pt-100 classe a com indicação do valor na tela; (16) interrupção da contagem do tempo de esterilização caso a temperatura da câmara interna fique abaixo da programada. a contagem deve ser retomada após a elevação da</p>	1	R\$ 18.447,00	R\$ 18.447,00

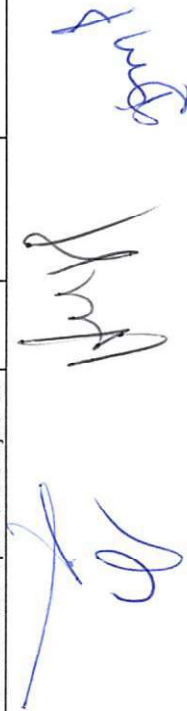



Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



		<p>temperatura até o valor programado; (17) no início do ciclo devem ser impressos a data, hora, número do ciclo, código da carga (definido pelo cliente), código do ciclo selecionado e parâmetros do ciclo selecionado, por impressora acoplada no painel de carga do equipamento; (18) entrada de ar para quebra de vácuo através de filtro de 0,22µm substituível; (19) bomba de vácuo de simples estágio com potência mínima de 1/4 hp; segurança: (1) válvula de segurança ajustada e lacrada em 3 kgf/cm2 e com dispositivo para verificação de funcionamento na câmara interna e gerador de vapor; (2) manômetro para acompanhamento da pressão da câmara; (3) manovacuômetro para acompanhamento da pressão negativa da câmara; (4) acionamento de alarme sonoro caso a temperatura da câmara interna exceda em 3°C a temperatura programada. se a temperatura exceder em mais de 3°C do valor programado, o ciclo deverá ser abortado ou cancelado; (5) impossibilidade do início do ciclo ou entrada de vapor na câmara interna caso a(s) porta(s) não esteja(m) completamente fechada(s); (6) impossibilidade de abertura da(s) porta(s) durante o ciclo ou quando a câmara interna esteja com uma pressão superior a 0,1kgf/cm2; (7) caso haja queda de energia o equipamento deverá despressurizar a câmara interna; (8) impossibilidade de entrar em uma nova fase do ciclo caso a anterior não tenha sido concluída; (9) sinalização ao operador caso haja demora excessiva no alcance de algum parâmetro programado no ciclo; (10) bloqueio no funcionamento do equipamento caso haja detecção de queda de pressão no fornecimento de vapor ou no fornecimento de água para a bomba de vácuo; (11) caso haja alguma falha durante o processo de esterilização o ciclo deverá ser abortado com indicação no visor e impressão da(s) causa(s) da provável falha. gerador de vapor: potência máxima de 9kw; construído em aço inoxidável aisi 304, ou superior; tubulação construída em aço inoxidável para evitar contaminantes; fornecimento de vapor saturado com suficiente entre 2,0 a 3,0kgf/cm2; sistema de controle de nível de água automático, válvula solenóide para alimentação automática de água, bomba para alimentação de água com capacidade de fornecimento com câmara de geração pressurizada, válvula de segurança com dispositivo para verificação de funcionamento, pressostato ajustável para controle automático da pressão de trabalho. alimentação elétrica: tensão de trabalho 220 volts (trifásico) acessórios: (1) cestos em quantidade suficiente para o carro internode carga, construído em aço inoxidável aisi 316l com acabamento eletropolido; (2) 01 (uma) impressora acoplada ao painel de comando (especificação na descrição do comando); (3) 01 (um) sistema purificador de água por osmose reversa com, no mínimo, as especificações abaixo relacionadas: (4) produção de água purificada compatível com o consumo da autoclave de no mínimo 32 l/h de vazão; (5) pré-filtro para sedimentos; (6) filtro de carvão ativado; (7) membrana(s) de osmose reversa; (8) pós-filtro; (9) sistema automático de funcionamento; (10) sistema automático de proteção contra falta de água; (11) 01 (um) reservatório de no mínimo 100 litros para água purificada. (12) rejeição de pelo menos 97% de sais dissolvidos na água a 25 graus centígrados</p>		
MEDICAÇÃO E SALA ODONTO	AR-CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTUS COM INSTALAÇÃO	ar condicionado digital inverter 12000 btus frio; voltagem: 220v; cor branca; 12000 btus; ciclo: frio; capacidade de resfriamento (mínimo - máximo, btu/h):2,250 14,300 btu/hr	2	R\$ 3.980,00
CONSULTORIO	ARMÁRIO AUXILIAR ( A86 CM, L 36CM, P 35 CM)	armário balcão auxiliar, dimensões aproximadas do produto: 74.5 x 60 x 36.5 cm (a x l x p), possui chave na porta	6	R\$ 700,00
SALA DE REUNIÃO	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM CHAVE E 4 PRATELEIRAS (1,98	armário de aço 2 portas com chave e 4 prateleiras (1,98 altura x 90 de largura)	1	R\$ 1.950,00




Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



ADMINISTRAÇÃO	ALTURA X 90 DE LARGURA)				
ADMINISTRAÇÃO	ARMARIO GAVETEIRO DE ESCRITÓRIO	gaveteiro volante com 02 gavetas e 01 gaveta pasta	4	R\$ 642,00	R\$ 2.568,00
ADMINISTRAÇÃO O E SALA ODONTO	ARMÁRIO SUSPENSO BASCULANTE EM MDF BRANCO COM 2,98 X 0,90 X 0,43 M	armário aéreo basculante, amplo espaço interno para acomodar materiais, estrutura reforçada em 100% mdf de 15mm, acabamento em pintura uv (brilho). com porta basculante com dobradiças metálicas e pistão a gás e com puxador perfil, módulo aéreo com porta basculante 80 cm - 3059.20.1 altura 34 cm largura 80 cm profundidade 31,4 cm sistema de montagem parafusos e cavilhas.	3	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00
CONSULTÓRIO	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO	balança antropométrica digital até 200 kg w300a - branca - 40x50 - led- divisões de 50g;- régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m;- display led com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura- plataforma com pintura a pó de alta resistência;- estrutura em aço carbono;- cor branca;de pintura em esmalte pu;- homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem;	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
CONSULTÓRIO	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA	balança digital pediátrica - aprovada pelo inmetro - capacidade máxima 25 kg, divisões de 5 g; displays operador (frontal): led 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; painel à prova de respingos, 2 teclas (zero e tara); concha anatômica com medidas 540x280 mm, material anti-germes pés reguláveis; cobertura em plástico; fonte externa: 110 a 240 vac c/ chaveamento automático; output: dc 6v ± 500ma; função tara até 100% da capacidade máxima de pesagem; homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem	2	R\$ 1.399,00	R\$ 2.798,00
CONSULTÓRIOS	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR COM RODÍZIOS EM AÇO INOX	biombo triplo hospitalar com rodízios em aço inox	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
SALA DE COLETA	BRACADEIRA	base esmaltada de tubo 2,5x2,5cm com 30x30cm (larg. x compr) e tubo inferior diâmetro 7/8 (22,22mm), regulagem da altura por mandril, tubo superior inoxidável, com concha em aço inoxidável com regulagem por manípulo. medidas : altura mínima 0,80 mt e 1,10 mt. máxima.	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
CONSULTÓRIOS , ADMINISTRAÇÃO O E GERENCIA	CADEIRA DE CONSULTÓRIO ESTOFADO COM BRAÇO E RODIZIO	cadeira escritório tradicional - nacional - em corino preto com apoio de braço regulável .estrutura estrela com mecanismo relax e regulagem de altura a gás.	15	R\$ 650,00	R\$ 9.750,00
CONSULTÓRIO	CADEIRA DE CONSULTÓRIO ESTOFADO COM RODIZIO	cadeira escritório tradicional - nacional - em corino preto sem apoio de braço regulável .estrutura estrela com mecanismo relax e regulagem de altura a gás.	25	R\$ 629,00	R\$ 15.725,00
CONSULTÓRIO	DETECTOR DE BATIMENTO FETAL	detector de batimento fetal	1	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
CONSULTÓRIO	ESTADIOMETRO PORTÁTIL	estadiometro portátil	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
RECEPÇÃO/FARMÁCIA	ESTANTE EM AÇO	estante de aço com 30 cm de profundidade com 06 prateleiras linha prática & fácil, com reforço simples resistente a 25kg (por prateleira) e colunas bipartidas. produzido em "chapa 26" (0,45 mm), podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você precisar com segurança e praticidade. ela ainda pode ser montada como dois balcões com 3 prateleiras cada.	15	R\$ 470,00	R\$ 7.050,00
CONSULTÓRIO	FOCO REFLETOR	com uma lâmpada, filtro atérmico espelhado, haste flexível cromada suporte com apoio pintado na cor branca, com 3 rodízios, 110v.	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00

*[Handwritten signatures and initials]*

COPA	GELADEIRA FROST FREE 370 LITROS DUPLEX BRANCO 110V	1	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
SALA DE ESPERA	LONGARINA 2 LUGARES TIPO AEROPORTO	10	R\$ 1.131,00	R\$ 11.310,00
SALA DE ESPERA	LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO	10	R\$ 1.392,00	R\$ 13.920,00
SALA DE EMERGÊNCIA	MACA DE TRANSPORTE	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
SALA DE MEDICAÇÃO E COLETA	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIOS 40X60	3	R\$ 1.038,00	R\$ 3.114,00
CONSULTÓRIO	MESA DE ESCRITÓRIO CONSULTÓRIOS	8	R\$ 830,00	R\$ 6.640,00
COPA	MESA PARA REFETÓRIO 8 LUGARES	1	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
CONSULTÓRIO	NEGATOSCOPIO	5	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
SALA DE INALAÇÃO/MEDICAÇÃO	POLTRONA RECLINÁVEL	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
SALA DE ESPERA	TELEVISÃO SMART DE 32 FULL HD EM LED	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

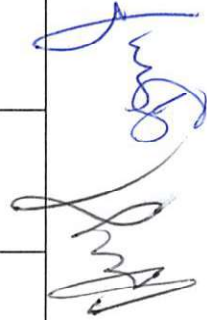



geladeira frost free 370 litros duplex branco 110v

longarina metálica com 2 lugares, barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braços aço inoxidável, pés formato de y em aço inoxidável com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço inox perfurada.

longarina metálica com 3 lugares, barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braços aço inoxidável, pés formato de y em aço inoxidável com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço inox perfurada.

maca prancha longa em madeira com cintos para resgate confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz. sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos). acompanha jogo de cintos somente c/ 3 peças.

mesa auxiliar inox com rodízios 40x60

mesa de 1,20m x 0,70m, com tampo e retaguarda lisos produzidos em mdp com 15 mm e acabamento em fita de 1mm, pés duplos aberto produzidos em aço e sapata niveladoras de altura.

mesa de refeitório com banco acoplado 8 lugares. medidas: máximo 2 metros de comprimento.

negatoscopio

especificações: poltrona para descanso e acompanhante reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, sendo a última a posição trendleburg/encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 revestido em courovin de fácil assepsia; poltrona reclinável através de mola com acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento); poltrona com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente; pintura epóxi, através de processo eletrostático a póps com ponteiros plásticos. opcional rodízios. medidas: posição normal: c=1,00m x l=0,75 m, altura do assento: 0,55 m, largura assento (interno): 0,53 m, posição reclinada: c=1,65 m x l=0,75 m a=0,55 m

smart tv - 32 polegadas: • recursos de vídeos: dnr, receptor dtv, cc, info, guide, sleep, midiast; • recursos/funcionalidades: resolução hd (1366 x 768 pixels); • processador: quad core; • consumo (kw/h): < 1kwh; • recursos de áudio: dolby audio, sap/mts, som surround; • tecnologia da tela: led; • taxa de atualização: 60hz; • outras conexões: entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) 1, entradas hdmi e 1 entrada hdmi (arc)², entrada rf para tv aberta (digital e analógica) e tv à cabo, 1 entrada usb: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada s/pdif out optical, 1 entrada ethernet, 1 entrada de áudio analógica.

obs: o dispositivo acima mencionado serve como referência, e pode ser substituído por um dispositivo de qualidade igual ou superior ao mencionado.



